

可变轴透镜场与电子光学特性计算

对可变轴透镜系统的电磁场、电子束轨迹进行仿真计算，用以分析系统的电子光学特性，与对系统结构与参数进行优化。

赵瑞博，郭晨瑜，宋学锋，俞大鹏

南方科技大学，深圳，广东，中国。

摘要

可变轴透镜 (Variable Axis Lens, VAL) 是搭建高分辨率大扫描场电子光学系统的重要思路，其通过在电磁透镜内部引入偏转场实现透镜光轴的移动，使偏离对称轴入射电子束依然能够沿移动后的可变轴透镜光轴传播、聚焦，从而大幅降低聚焦电子束的离轴像差。

通过对可变轴透镜三维场分布与电子束轨迹的计算，并进一步计算和分析了电子束离轴距离以及有无离轴场存在情况下的像面粒

子分布对比。以在x方向偏离1cm处的九宫格电子簇发射为例，仿真计算结果表明，有偏转场存在的VAL可以达到大幅减小系统的离轴像差的效果。该工作给出了一个通用的VAL基础模型和普遍的结构参数，验证了VAL可以实现离轴的理论预测模型，计算结果和经验为创新型的VAL设计和基于此结构的带电粒子束系统开发和级联奠定了基础。

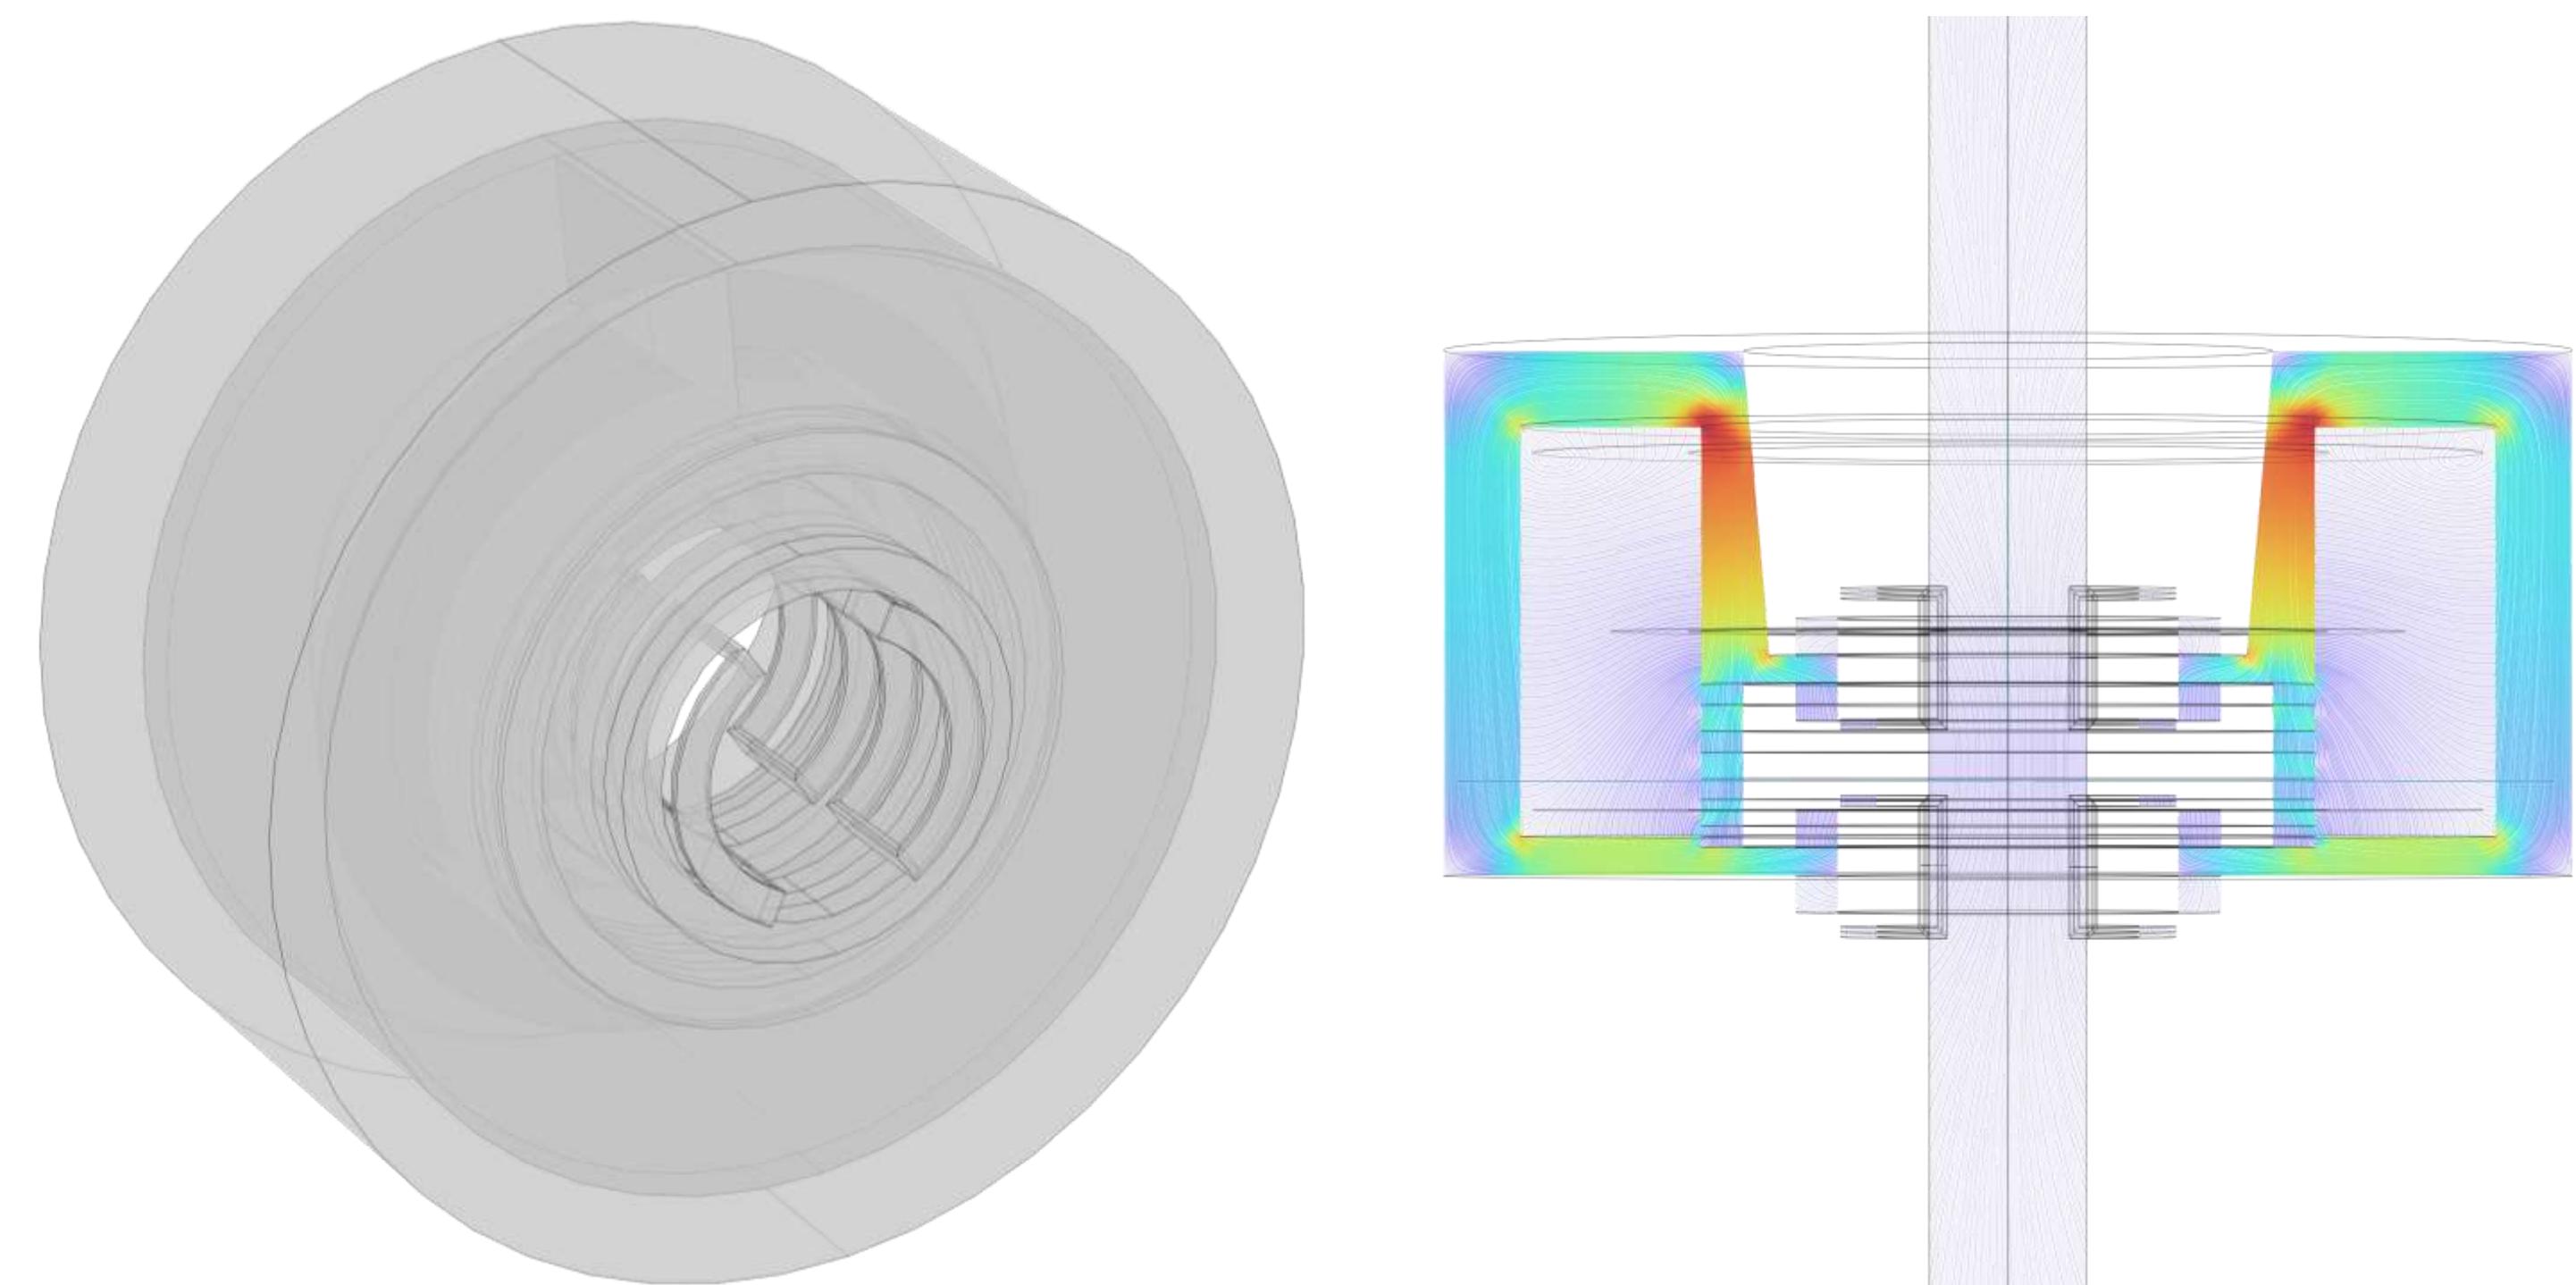


图1. 左：VAL的几何结构。右：VAL的三维场分布计算结果的x-z平面截面图

结果

对引入移轴场后的移轴聚焦场进行分析，可以得到在设定参数下的移轴距离，进一步通过参数化扫描，得到在1A聚焦电流下，当移轴线圈设定为0.417A时可使聚焦场光轴移动1cm。

离轴1cm入射电子束聚焦轨迹如图2中左图所示，可以看到电子束如预期般沿离轴1cm直线聚焦。对比相同入射参数下存在移轴场与纯聚焦场下像面处电子分布可以看到，纯聚焦场电子束具有明显彗差，电子束斑形变明显；VAL像面电子基本维持圆形光斑，且此光斑可通过消像散器有效缩小，VAL对于普通圆透镜对于大偏转场偏转的优势得到验证。

参考文献

1. Schmid P, Rose H. Outline of a variable-axis lens with arbitrary shift of the axis in one direction[J]. Journal of Vacuum Science & Technology B Microelectronics & Nanometer Structures Processing Measurement & Phenomena, 2001, 19(19):2555-2565.
2. Qingmao Zhang, Qirui Wang, Delong Chen, Junbiao Liu, Yanjun Zhang, Quantong Li, Zhuming Liu. Comparative study on variable axis lens systems based on tapered deflectors[J]. Journal of Vacuum Science & Technology B Microelectronics & Nanometer Structures Processing Measurement & Phenomena, 2024, 42(4):042801.
3. 夏善红, 朱协卿. 扫描电子束曝光机复合物镜的研究与设计[J]. 电子与信息学报, 1991, 13(2): 183-192.

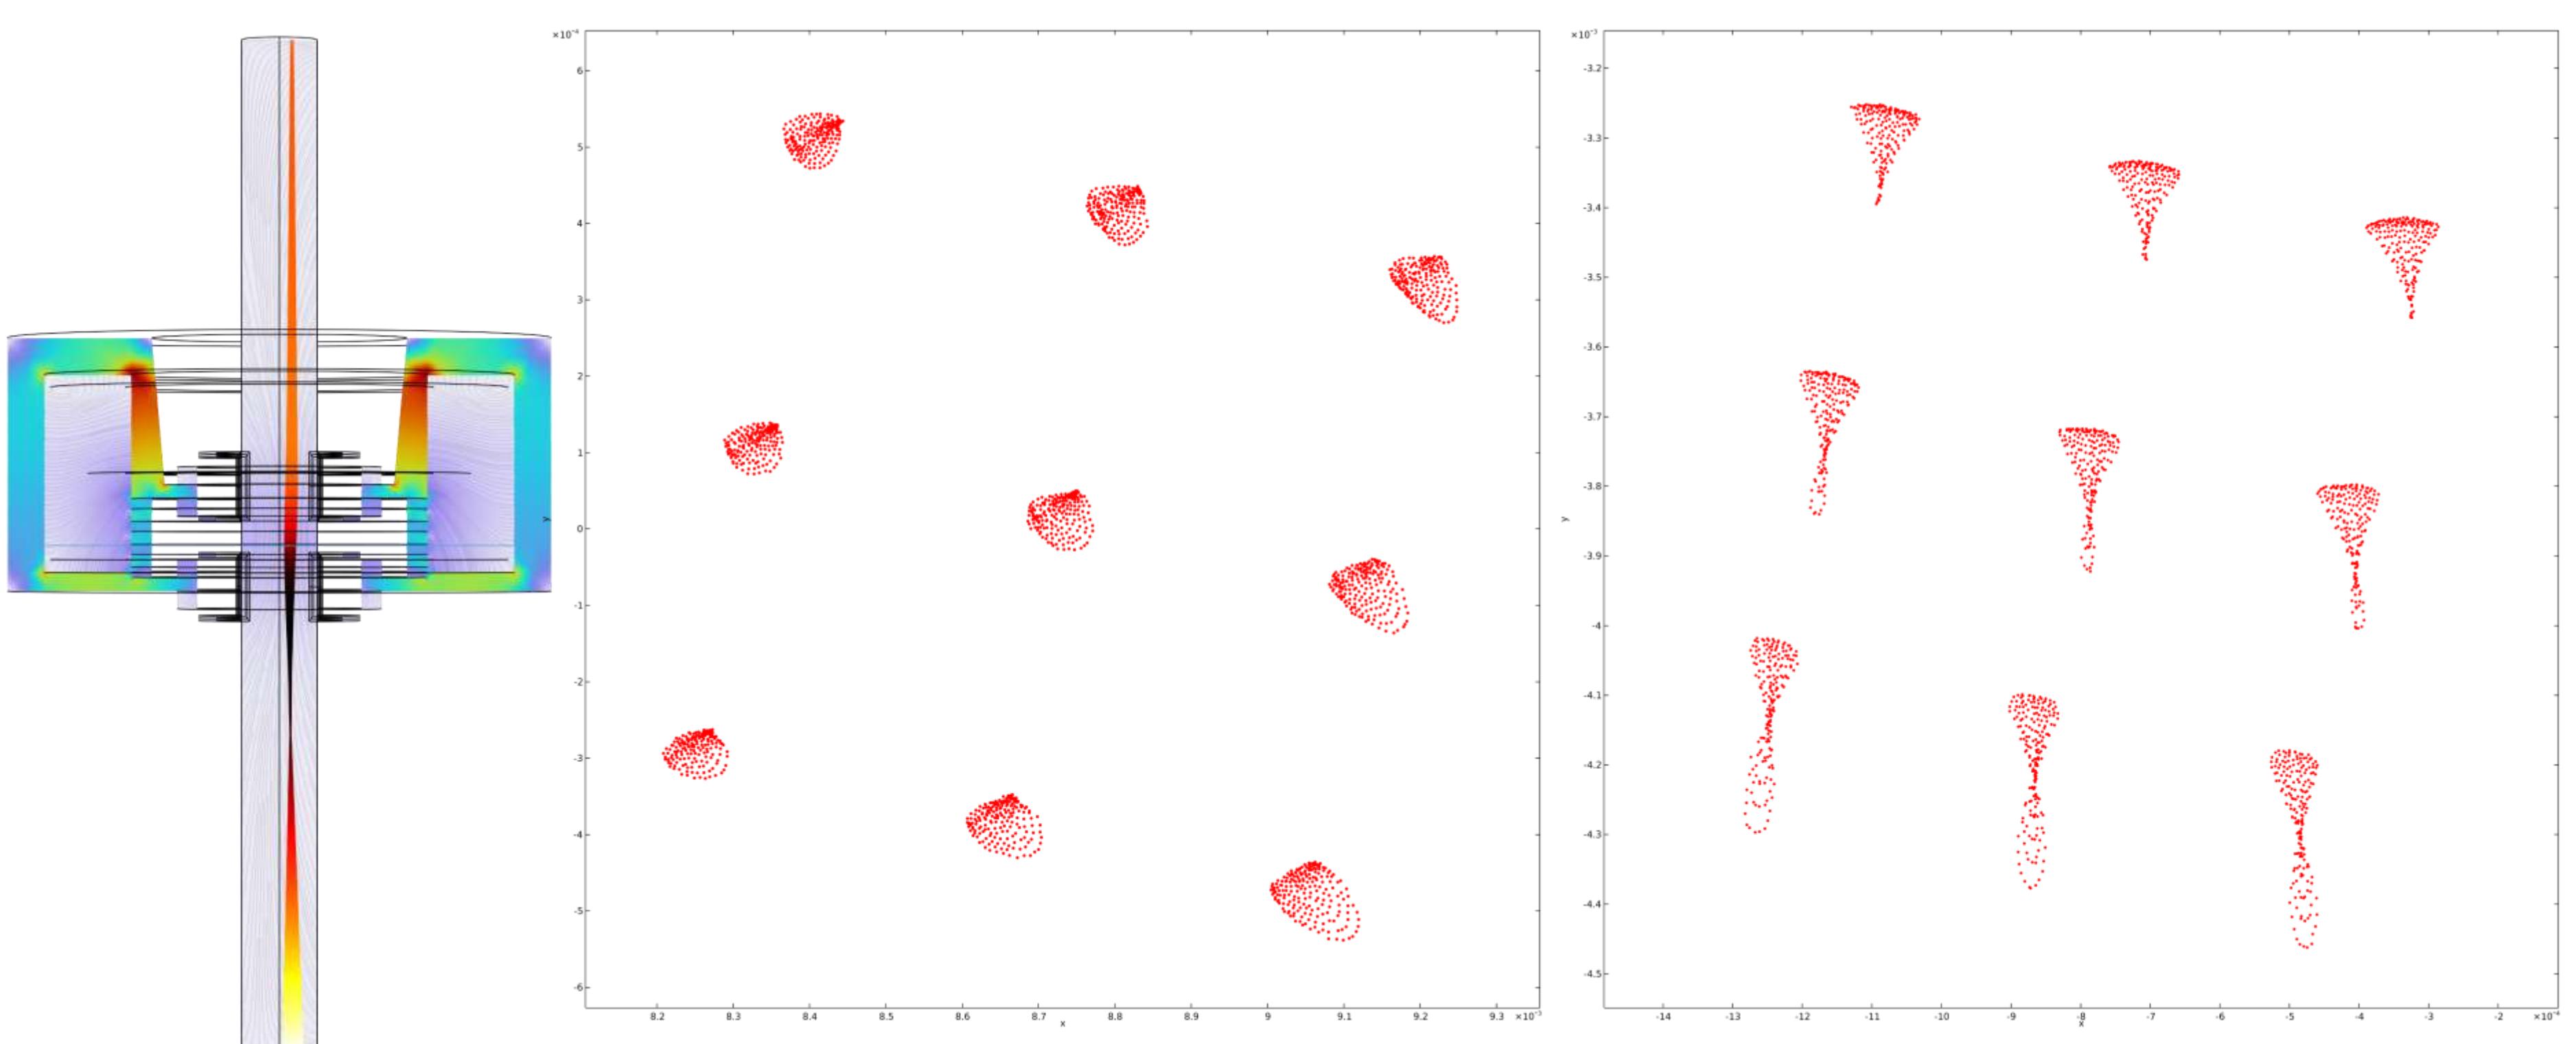


图2. 左：透镜场分布与离轴聚焦电子束轨迹。中：VAL在x方向偏移1cm的像面电子分布。右：不存在移轴场偏转的情况下像面电子分布。



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY